


Möglicher Verdrehwinkel der Stellfüße 360°
 Potential demand of torsion angle for the supporting feet 360°

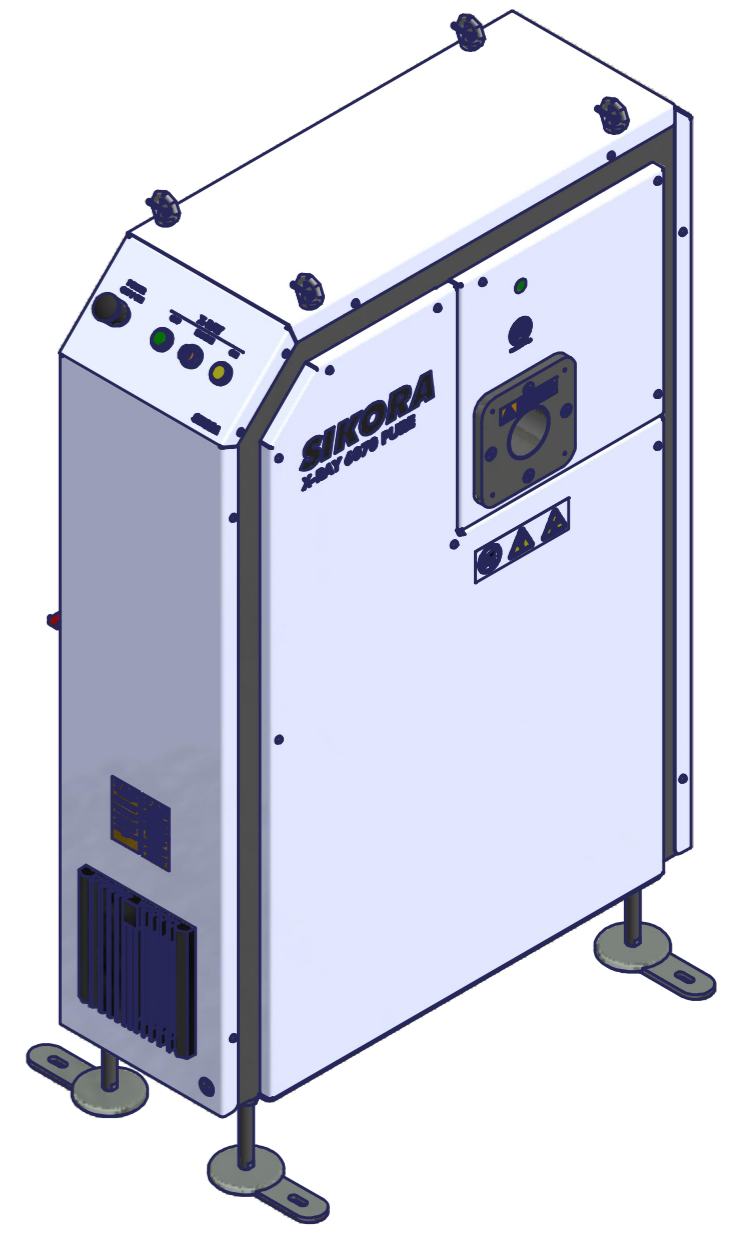

Identnummer / Part no.		Allgemeintoleranzen General tolerances ISO 2768-mK		Maßstab / Scale 1 : 10		Gewicht / Weight	
				Benennung / Title X-RAY 6070 PURE mit internem Strahlenschutz measuring device		Revision 1 / 1 Original size DINA2	
		Date 18.08.2025 Name dpfingsten		Zeichnungsnummer / Dwg no. GA61-138635		Rev. -	
		Checked 01.10.2025 bschwecke		SIKORA SIKORA GmbH Bruchweide 2 28307 Bremen Germany		File 138635.idw	
Rev	Modification	Date	Name	File 138635.idw		Rev. -	